



## РУКОВОДСТВО ПО РАБОТЕ С КАНАЛАМИ ЭНДОСКОПОВ EVIS EXERA III

### Подсоединение заглушки канала и трубки для введения жидкости к аспирационному/воздушному/жидкостному каналу

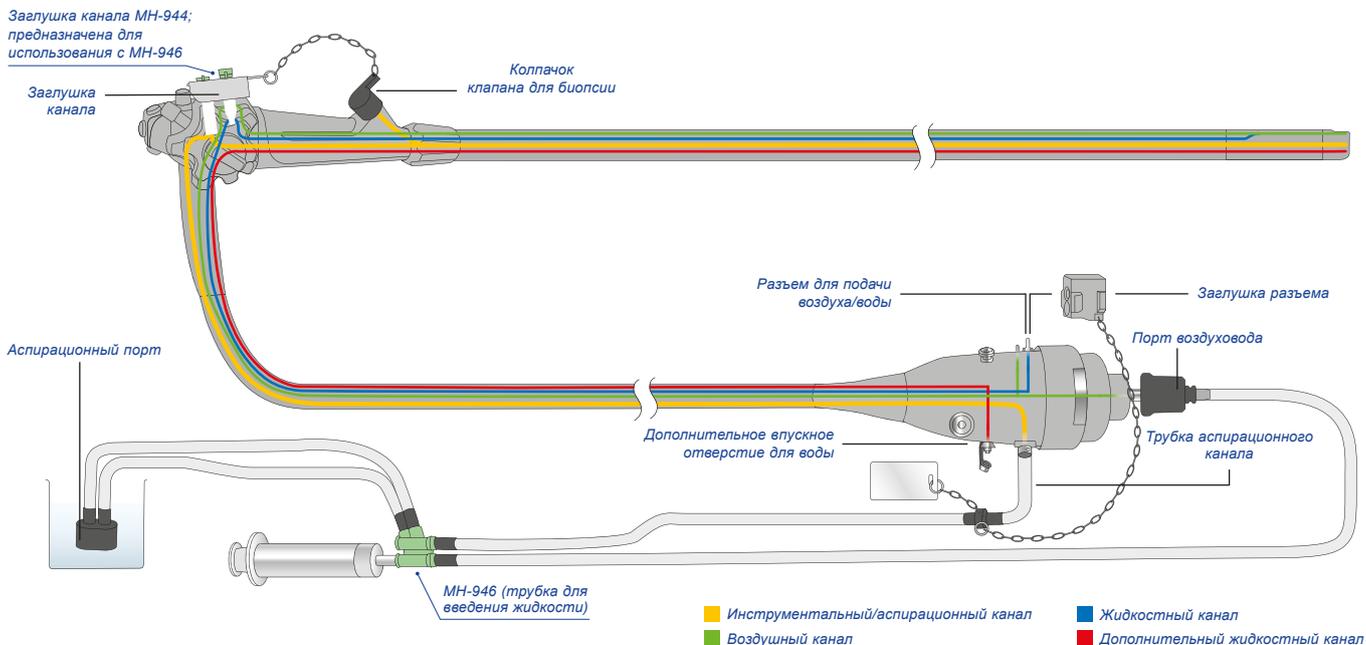


### Дополнительные каналы для EVIS EXERA III и более ранних моделей эндоскопов

#### Дополнительное впускное отверстие для воды на разъеме эндоскопа

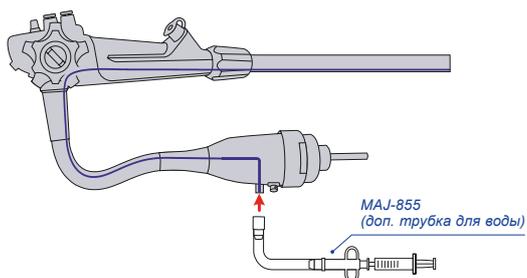

#### Заглушка канала подъемника дуоденоскопа (не относится к TJF-Q180V)

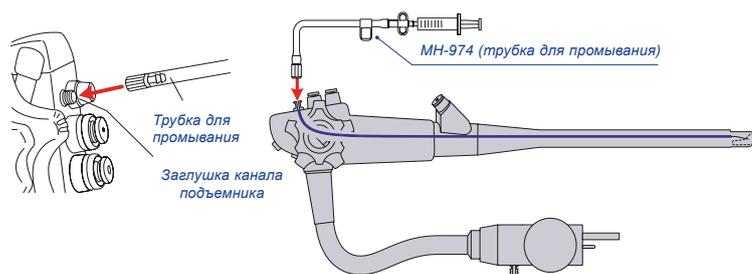

Данная информация не заменяет руководство по эксплуатации. Необходимо всегда обращаться к содержащимся там инструкциям.